


(4) INFRACRVENA SPEKTROFOTOMETRIJA

Ispitivanje prevlaka odvojenih od aluminijumske osnove je izvršeno na FTIR spektrofotometru, Bomem 100, Bomem Hartman, Infracrveni spektrofotometar, opseg 4000-400 cm^{-1} .

proizvod (II), priložen spektrogram, slika 3a

proizvod (III), priložen spektrogram, slika 3b

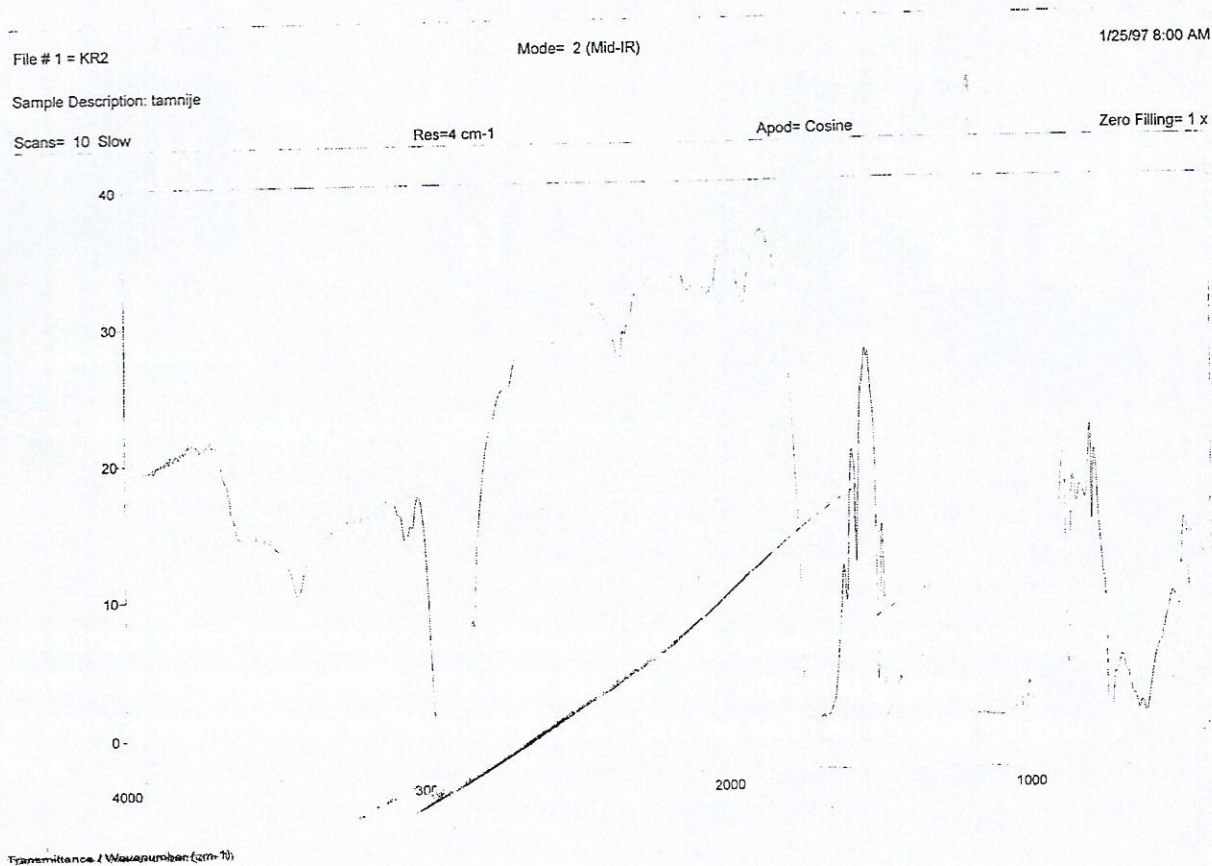

Slika 3a. FTIR spektrogram uzoraka proizvoda (II)